

El Root ZX mini es compacto, ligero y diseñado para adaptarse a la mano. Puede ser situado en una bandeja, sobre el cobertor del paciente o en cualquier otro lugar.



Equipos para diagnóstico y formación de imágenes



Unidades terapéuticas



Piezas de mano e instrumentos



Sistemas de endodoncia



Sistemas de láser



Equipos de laboratorio



Root ZX mini

Diseño junto a precisión



Distribuido por
J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 27a
63128 Dietzenbach
Germania
T +49. 6074. 836 0, F +49. 6074. 836 299
www.morita.com/europe

Desarrollado y fabricado por
J. MORITA MFG. CORP.
680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku
Kyoto 612-8533
Japan
T +81. 75. 611 2141, F +81. 75. 622 4595
www.morita.com

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y al contenido de errores.
JME ES PUB 1092 0716 *2.


Thinking ahead. Focused on life.





- Colores disponibles**
- Blanco
 - Rojo
 - Verde
 - Azul

Mediciones del conducto radicular exactas y precisas con el Root ZX mini

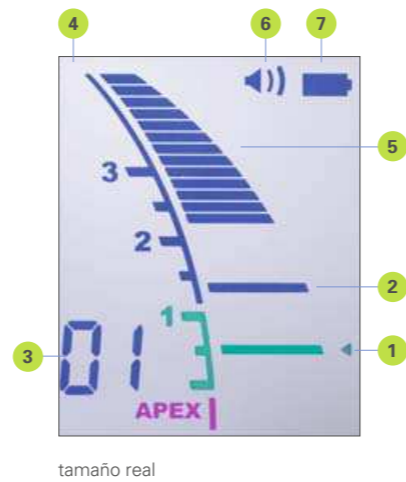

La posición de las barras intermitentes y de la barra de memoria pueden ser utilizadas como guías para la medición del conducto y para su conformación.

1 - Barra intermitente

El punto de referencia para la medición o conformación puede ser marcado en cualquier punto entre el 2 y el ápice.

2 - Barra de memoria

Puede ser utilizada para marcar el inicio de una curva cerrada o algún punto concreto desde el ápice. Puede ser utilizado también como guía cuando cambiamos de lima para conformar el conducto. La barra de memoria puede ser situada solo para la establecer medición.

3 - Pantalla de información



El número de barras que faltan antes de alcanzar la barra intermitente (durante la medición). Distancia de la barra de memoria a la intermitente (sin medición).

4 - Pantalla de cristal líquido


5 - Barras indicadoras de la longitud del conducto

6 - Volumen del sonido (quitado, bajo, alto)


7 - Indicador nivel batería

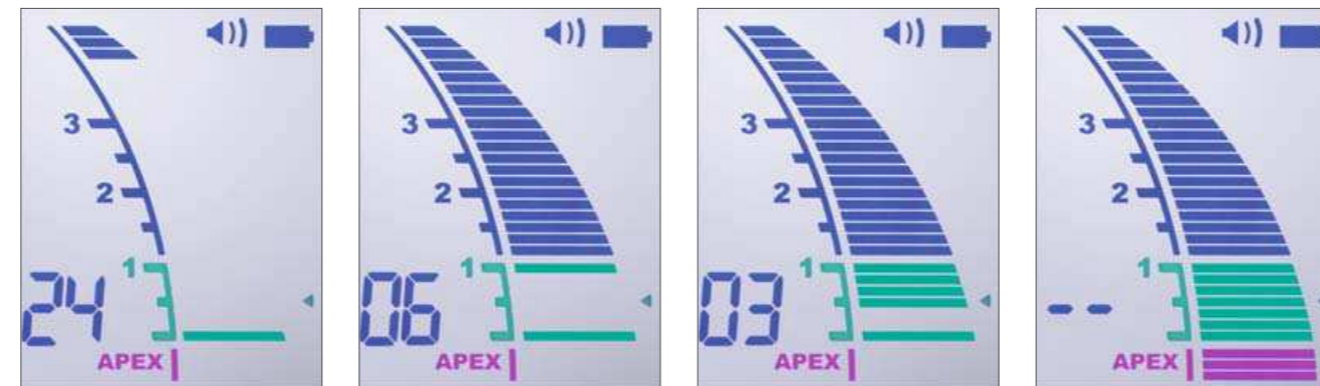


La medición se activa cuando la lima se introduce en el conducto radicular. El número de barras restantes antes de que la lima alcance la barra intermitente se muestra en la parte inferior de la esquina izquierda de la pantalla.



Cuando la punta de la lima alcanza la zona cercana al ápice, la barra cambia al color verde para indicarnos que hemos alcanzado la zona crítica.



El pequeño triángulo a la derecha de las barras indicadoras indica el punto marcado para referencia.



La posición del ápice está representada por la palabra "APEX". La barra de posición en esta zona es rosa.

Especificaciones



Especificaciones	
Nombre	Root ZX mini
Modelo	RCM-7
Potencia	DC 4,5 V
Consumo	0,2 W
Tamaño	60 mm x 103 mm x 57 mm
Peso	aprox. 110 g



- Accesorios del Root ZX mini**
- 1 x cable de sonda
 - 3 x portalimas
 - 5 x contraelectrodo
 - 1 x verificador
 - 3 x pilas DC 1,5 V tamaño AAA

Diseño compacto y ligero

La fabricación con los estándares de calidad del Root ZX, permite al Root ZX mini ser el líder en su categoría en exactitud tanto en canales secos como húmedos.

Exactitud en la medición

Utilizando la técnica del ratio, el Root ZX mini indica la localización de la lima con una alta eficiencia. La exactitud de la medida no se afecta por la presencia o ausencia de sangre, otras secreciones, electrolitos, salino, agua corriente o peróxido de hidrógeno.

No es necesario ajustar a cero

No es necesario ajustar el aparato a cero antes de la medición de cada conducto.

Auto calibración

La calibración automática asegura la exactitud y elimina el efecto producido por los cambios de temperatura, humedad, etc en el interior del conducto, incluso durante el tratamiento.

Pantalla a color de cristal líquido

La pantalla a color de cristal líquido permite una fácil lectura, proporcionando una pantalla clara y con elevado contraste.